

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Odp. nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: „**Materiały opatrunkowe**”, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwot, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp, ogłoszonego w BZP pod numerem: 2026/BZP 00172071/01 z dnia 26.03.2026 r.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, Zamawiający informuje jak niżej:

1. **Pytania do Zadania nr 17** - Prosimy o wydzielenie pozycji 5-8 do innego Pakietu lub podzielenie Pakietu na pozycje. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

2. **Pytania do Zadania nr 17** - Pozycja 1- Prosimy o dopuszczenie opatrunku spełniającego wymogi SWZ a klejem naniesionym równomiernie oraz bez nacięć na brzegach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. **Pytania do Zadania nr 17** - Pozycja 2- Prosimy o dopuszczenie opatrunku spełniającego wymogi SWZ a klejem naniesionym równomiernie oraz bez nacięć na brzegach. Wyrób klasy Is. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. **Pytania do Zadania nr 17** - Pozycja 3- Prosimy o dopuszczenie opatrunku spełniającego wymogi SWZ a klejem naniesionym równomiernie oraz bez nacięć na brzegach, z jednym paskiem mocującym. Wyrób klasy Is. Rozmiar 7x8,5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

5. **Pytania do Zadania nr 17** - Pozycja 4- Prosimy o dopuszczenie opatrunku spełniającego wymogi SWZ bez nacięć na brzegach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

6. **Zad 10 poz 11** - Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 16x20 o tożsamyh właściwościach?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

7. **Zad 10 poz 12** - Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 22x25 o tożsamyh właściwościach?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

8. **Do umowy:** Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

9. **Zadanie 1, pozycja 8-10** – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu „krzyżak”?

Odp. Nie.

10. **Zadanie 1, pozycja 8-10** – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie namaczania około 5s?

Odp. Nie.

11. Zadanie 1, pozycja 8-10 – Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania ok 3min.?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

12. Zadanie 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców i opatrunków pokrytych hipoalergicznym klejem akrylowym we wszystkich pozycjach, gdzie wymagany jest klej kauczukowy?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

13. Zadanie 2, pozycja 4 – 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców na rolce?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

14. Zadanie 2, pozycja 5 – 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pokrytych klejem naniesionym metodą ciągłą, a nie paskami?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

15. Zadanie 2, pozycja 25-28 – Czy Zamawiający ma na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie rękawa o długości 10m w stanie spoczynku, 25 m w stanie rozciągniętym z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Odp. Tak, zamawiający wymaga rękawów opatrunkowych o długości 25 m w stanie rozciągniętym.

16. Zadanie 2, pozycja 30 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek o następujących parametrach: Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, ze wzmocnionym obrzeżem włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 8,5 cm x 11,5 cm?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

17. Zadanie 2, pozycja 31 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek o następujących parametrach: Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną, z dwoma paskami mocującymi z włókniny, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 9 cm x 7,2 cm?

Odp. Tak.

18. Zadanie 3, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści maski o następujących parametrach: Maska medyczna wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepyłającej włókniny (25g/m²+ 25g/m² + 25g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Dostępna w 2 kolorach: zielonym, niebieskim?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

19. Zadanie 3, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści maski o następujących parametrach: Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepyłającej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Dostępna w 2 kolorach: zielonym, niebieskim?

Odp. Tak

20. Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o czasie tonięcia <10s?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

21. Zadanie 5, pozycja 7, 8 – Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane jednostkowo w torebkę papier-folia z min. 1 etykietą kontrolną i w opakowanie zbiorcze pojedynczy karton?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

22. Zadanie 5 pozycja 7,8 – Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnym rozmiarze po rozłożeniu 31cmx37cm?

Odp. Tak

23. Zadanie 5 pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'20sztuk bez przewiązania?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

24. Zadanie 5, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk bez przewiązania z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

25. Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe z nacięciem Y 4 warstwowe?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

26. Zadanie 5 – Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe z nacięciem Y zarejestrowane w klasie IIa reg. ???


Odp. Tak.

27. Zadanie 5, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane a'4sztuki z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

28. Zadanie 12 poz.1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ortopedycznych na stole wyciągowym o składzie:

- 1x serweta główna o wymiarach 250cm x 300cm zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm,
- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,
- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 50cm x 60cm
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

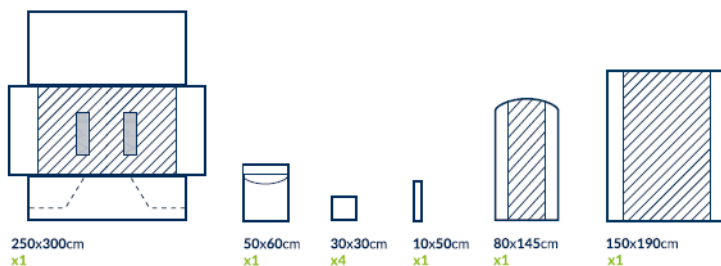

Odp. Tak.

29. Zadanie 12 poz.2 – Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 16 x 200 cm?

Odp. Tak.

30. Zadanie 12 poz.3 – Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?

Odp. Tak.

31. Zadanie 14, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści koszule z włókniny o gramaturze 33g/m2?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

32. Zadanie 14, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze granatowym?

Odp. Tak.

33. Zadanie 14, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

34. Zadanie 14, poz. 4 – W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Odp. Tak.

35. Zadanie 14, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Odp. Tak.

36. Zadanie 14, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z dwóch warstw celulozy (2x18g/m²) i warstwy folii (0,09-0,11mm)?

Odp. Tak.

37. Zadanie 14, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści o długości 40m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak.

38. Zadanie 14, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze: 23 gr ±5% (papier) + 14 gr ±5% (PE)?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

39. Zadanie 14, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

40. Zadanie 14, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści ubranie o następujących parametrach: Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w kolorze niebieskim. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPa zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3?

Odp. Tak.

41. Zadanie 14, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści Ubranie występujące w rozmiarze S-XXL?

Odp. Tak.

42. Zadanie 14, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach: Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 80 x 210 cm z wkładem chłonnym 60 x 200cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 26,88 g, dwóch warstw celulozy 32,76 g, pulpy celulozowej 113,76 g z superabsorbentem SAP 30,24 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 87,36 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 190 kg. Waga całkowita podkładu 295 g ±5g, chłonność 4372,1 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odp. Tak.

43. Zadanie 14, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach: Prześcieradło medyczne wzmocnione w rozmiarze 80 x 210 cm, kolor biały z 48 niebieskimi nitkami.

Wykonane z celulozy 23 g/m² oraz folii polietylenowej (PE) o gramaturze 17 g/m². Opakowanie 25 szt. Chłonność 140 ml?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

44. Zadanie 14, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach: Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 80 x 210 cm z wkładem chłonnym 60 x 200cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 26,88 g, dwóch warstw celulozy 32,76 g, pulpy celulozowej 113,76 g z superabsorbentem SAP 30,24 g, warstwa zewnętrzna (spodnia) 87,36 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 190 kg. Waga całkowita podkładu 295 g ±5g, chłonność 4372,1 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odp. Tak.

45. Zadanie 14, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej o gramaturze 25g?

Odp. Tak.

46. Zadanie 14, poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem o wymiarach 150cm x 210cm i poszwą 160cm x 210cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza prześcieradło i poszwę o zaproponowanych wymiarach, pod warunkiem że w skład zestawu wejdzie również poszewka o wymiarach jak w SWZ. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

47. Zadanie 14, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści koc o następujących parametrach: Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 80g/m², z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 210 cm.?

Odp. Tak.

48. Zadanie 14, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści koc o następujących parametrach: Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 77g/m², z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 150 x 210 cm.?

Odp. Tak.

49. Zadanie 1, poz. 8-10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie namaczania do 5 sekund oraz czasie wiązania do 5 sekund ?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

50. Zadanie 1, poz. 3,4,5: Czy Zamawiający wymaga opasek wiskozowych, o gramaturach

5 cm x 4m – 5,5 g
10 cm x 4m – 10 g
15 cm x 4m – 16 g ?

Opaski o zbyt niskiej gramaturze są często "rzadkie", co powoduje ich szybkie prucie się i strzępienie

Odp. Nie wymaga, zapisy SWZ bez zmian

51. Zadanie 1, poz. 6,7: Czy Zamawiający oczekuje opasek tkanych o składzie: 65,2% przędza bawełniana, 30,8% jedwab poliamidowy, 4% przędza elastomerowa ?

Taki skład zapewnia wysoką oddychalność opaski, przy jednoczesnej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiedniej elastyczności.

Odp. Nie oczekuje, zapisy SWZ bez zmian

52. Zadanie 3, poz.7: Czy Zamawiający oczekuje opasek tkanych o składzie: 65,2% przędza bawełniana, 30,8% jedwab poliamidowy, 4% przędza elastomerowa ?

Taki skład zapewnia wysoką oddychalność opaski, przy jednoczesnej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiedniej elastyczności.

Odp. Nie oczekuje, zapisy SWZ bez zmian

53. Zadanie 3, poz.7: Czy Zamawiający oczekuje opasek zapakowanych w torebkę papierowo-foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki - jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie. oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta ? Taki sposób pakowania oraz wymóg etykiet TAG jest właściwy dla oferowanych wyrobów jałowych.

Odp. Nie oczekuje, zapisy SWZ bez zmian

54. Zadanie 3 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania watę będącą wyrobem higienicznym, posiadającą stawkę VAT 23 % ?

Odp. Nie.

55. Zadanie 3, poz. 5-6: Czy Zamawiający wymaga, aby lignina zapakowana była w opakowanie foliowe chroniące przed zawilgoceniem?

Odp. Nie wymaga, zapisy SWZ bez zmian

56. Zadanie 3, poz. 6: Czy Zamawiający wymaga ligniny w arkuszach bielonej, równomiernie i widocznie marszczonej, bez obcego zapachu oraz niepylącej ? Marszczenie zwiększa powierzchnię właściwą arkusz - w wyniku marszczenia, lignina jest w stanie przyjąć i zatrzymać znacznie więcej płynów (krwi, wysięku, środków odkażających) niż gładki papier o tej samej wadze. Struktura dostatecznie marszczona jest mniej podatna na przypadkowe rozerwanie po namoczeniu w porównaniu do ligniny gładkiej lub lekko marszczonej, która w kontakcie z cieczą staje się bardzo podatna na defragmentację.

Odp. Tak.

57. Zadanie 5, poz. 7,8: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowanie zbiorcze - podwójny karton?

Odp. Tak, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

58. Zadanie 5, poz. Kompresy włókninowe z nacięciem Y, jałowe, 6 warstwy o gramaturze 30 g/m², kl.Is reg.4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 4-warstwowych ?

Odp. NIE. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

59. Pakiet 7 Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

Odp. Zamawiający pozostawia SWZ bez zmian.

60. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 1) majtki chłonne pozbawione wskaźnika chłonności, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Wskaźnik chłonności jest charakterystycznym elementem pieluchomajtek, które są stosowane przy średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu i kiedy to personel medyczny musi decydować o tym, czy dany produkt jest do zmiany. Majtki chłonne są rekomendowane dla osób mobilnych i świadomych, które przeprowadzają tzw. "trening toaletowy" i same kontrolują wypełnienie produktu - wskaźnik chłonności nie jest dla nich w żadnym stopniu przydatny. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję.

Odp. Tak.

61. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 1) majtki chłonne o chłonności 1440g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 1550 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 1440 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica 110 ml.

Odp. Tak.

62. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycje 1 - 5) produkty chłonne których poziom chłonności jest badany wg normy ISO 11948-1/Rothwell? Parametr retencji pełni rolę czysto poglądową na temat danego produktu i jego metoda badania nie jest znormalizowana (wiele metod badawczych). Parametr ten nie jest wiążący i wymagany przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP.

Odp. Tak, z zachowaniem przybliżonych parametrów chłonności podanych w SWZ

63. "Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycje 2 - 5) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Wymagania w opisie przedmiotu zamówienia utrudniają uczciwą konkurencję, gdyż dot. opisu produktu jednego producenta co preferuje określonego wykonawcę (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 lutego 2022 roku, sygn. akt KIO 248/22).

Odp. Tak.

64. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, które nie posiadają elementu, który pozwala na ich rozciąganie do 10 mm? Produkty, które chcemy Państwu zaoferować posiadają co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz elastyczny, rozciągliwy pas przedni, co stanowi alternatywę dla przylepcorzepów posiadających rozciągliwy element.

Odp. Tak.

65. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycje 1 - 5) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozplywa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?

Odp. Tak.

66. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycje 2 - 5) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte paroprzepuszczalnym laminatem nie przepuszczalnym dla cieczy, na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

67. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycje 3 - 5) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokrytych folią nie przepuszczalną dla powietrza i cieczy? Zastosowanie folii, która nie przepuszcza powietrza powoduje, że ciało pacjenta jest cały czas w wilgotnym środowisku co niesie wysokie ryzyko powstawania odleżyn i infekcji skórnych co z kolei zwiększa koszty opieki nad pacjentem.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

68. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 4) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o zakresie obwodu 70 - 141cm dla oczekiwanej pozycji rozmiaru L? Takie dopuszczenie zmniejszy koszty dla Zamawiającego i ułatwi pracę personelowi medycznemu - mniej rozmiarów pieluch.

Odp. Nie.

69. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 5) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 166cm dla oczekiwanej pozycji rozmiaru XL? Takie dopuszczenie zmniejszy koszty dla Zamawiającego i ułatwi pracę personelowi medycznemu - mniej rozmiarów pieluch.

Odp. Nie.

70. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 3) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o zakresie obwodu 70 - 141cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?

Odp. Nie.

71. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycje 2 i 4) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 166cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?

Odp. Nie.

72. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 5) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?

Odp. Tak.

73. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycje 2 - 5) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w układ szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

74. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycje 2 - 4) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające trzy ściągacze taliowe: jeden z tyłu i dwa boczne ściągacze, które rozciągają się o ok 3 cm każdy? Taka budowa pieluchomajtki zapewnia idealne dopasowanie produktu do ciała

Odp. Tak.

75. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 7) pieluchomajtki dla dzieci w przedziale wagowym 5-8kg?

Odp. Tak.

76. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 6) pieluchomajtki dla dzieci w przedziale wagowym 7-11kg?

Odp. Nie.

77. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 6) pieluchomajtki dla dzieci w przedziale wagowym 10-14kg?

Odp. Nie.

78. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 4, pozycja 6) pieluchomajtki dla dzieci w przedziale wagowym 13-20kg?

Odp. Nie.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku

mgr Elżbieta Gasińska-Batko